



Test Report

NO.: BOGHCQJR71729910

Issued Date: 2020-03-10

page 1 of 2

Applicant: NINGBO JOYSON TECHNOLOGY CO., LTD

The following sample(s) was/were submitted and identified on behalf of the client as:

Sample Name: Disposable medical masks(Non sterile)

Sample Description: Blue

Sample Quantity: 40

Sample Received Date: 2020-02-25

Test Period: 2020-02-25~2020-03-10

Test Item: Please refer to next page(s)

Test Methods: Please refer to next page(s)

Test Result: Please refer to next page(s)

Approved by



Jimmy Xiang

The page below is blank

Test Report

NO.: BOGHCQJR71729910

Issued Date: 2020-03-10

page 2 of 2

Test Result

Test Item	YY/T 0969-2013 Limit	Test Result		Determine	Test Methods
Bacterial filtration efficiency, % (BFE)	≥95	97.7		Conform	YY/T 0969-2013
Ventilation resistance, Pa/cm ²	The ventilation resistance of gas exchange between two sides of the respirator shall not be greater than 49	No.1	26	Conform	
		No.2	27		
		No.3	26		
Ethylene oxide residue, µg/g	≤10	3.9		Conform	
Total number of bacteria community, cfu/g	≤100	<20		Conform	
Coliform bacteria	Negative	Not Detected		Conform	
Pathogenic pyogenic bacteria	Pseudomonas aeruginosa	Negative	Not Detected	Conform	
	Staphylococcus aureus	Negative	Not Detected	Conform	
	Hemolytic streptococcus	Negative	Not Detected	Conform	
Total number of fungal colonies, cfu/g	Negative	Not Detected		Conform	



Sample No. & Photo:



Pony authenticate the photo on original report only
End of Report

检测报告

Test Report

报告编号: **SL22002232596201TX**

Report No.: **SL22002232596201TX**

样品名称 : 一次性使用医用口罩(非灭菌)
Sample Name : **Disposable medical masks(Non sterile)**

委托单位 : 宁波均胜科技有限公司
Applicant : **NINGBO JOYSON TECHNOLOGY CO.,LTD**

检测类别 : 委托检测

Test Type : Submitted by client



报告编号: SL22002232596201TX
Report No.: SL22002232596201TX

检测报告

Test Report

样品信息 Sample information	样品名称 Sample name	一次性使用医用口罩(非灭菌) Disposable medical masks(Non sterile)	规格型号 Specification type	175*95mm(JS01-00)
	样品批号/ 生产日期 Lot No./ Date of manufacture	2020032711	有效期 Validity term	/
	样品数量 Sample quantity	70	样品状态 Sample state	完好 Good
	生产单位 Manufacturer	宁波均胜科技有限公司 NINGBO JOYSON TECHNOLOGY CO.,LTD		
客户信息 Client information	委托单位 Applicant	宁波均胜科技有限公司 NINGBO JOYSON TECHNOLOGY CO.,LTD		
	委托单位地址 Applicant address	浙江省宁波市高新区凌云路 198 号 NO.198 LINGYUN ROAD, HI-TECH PARK, NINGBO, ZHEJIANG,315040		
检测信息 Test information	样品接收日期 Sample Receiving Date	2020-03-30	样品检测周期 Test Period Date	2020-03-30~ 2020-04-18
	样品编号 Sample No.	(A)	检测环境 Test environment	符合要求 Meet requirement
	检测项目 Test items	请参见下页 See below pages		
	检测依据 Testing Accordance	YY/T 0969-2013 《一次性使用医用口罩》 YY/T 0969-2013 《Single-use medical face mask》		

通标标准技术服务(青岛)有限公司
SGS-CSTC Standards Technical Services (Qingdao) Co., Ltd.
第 2 页 共 7 页



除非另有书面协议,本报告由本公司依据《服务通用条款》出具。

《服务通用条款》印刷在正本报告纸背面,或通过 <http://www.sgs.com/en/Terms-and-Conditions.aspx> 查询,电子格式文件可通过 <http://www.sgs.com/en/Terms-and-Conditions/Terms-e-Document.aspx> 获取。请特别关注其中涉及责任限定,赔偿以及司法管辖的相关条款。任何报告的持有方需知悉,此报告内容仅反映SGS受限于客户指示下,且在当时所得结论。SGS仅对其客户负责,并且此报告不能免除交易各方根据交易文件所享有的权利和应履行的义务。未获得本公司书面批准,本文件不得进行复制,全文除外。任何未经授权对报告内容及形式进行的修改、伪造或扭曲都是违法行为,违法者将会被追究法律责任。

注意: 检测/检验报告或证书的真实性,请通过电话(86-755)83071443或邮箱CN.Doccheck@sgs.com查询。
中国·青岛·城阳区株洲路143号通标中心 邮编:266101
www.sgs.com.cn
t (86-532) 6899888 f (86-532) 80991955 e sgs.china@sgs.com



报告编号: SL22002232596201TX
 Report No.: SL22002232596201TX

检测结论 Test conclusion	本报告仅提供实测数据和单项判定, 详见检测结果汇总页。 This report only provides the test results and individual judgment, conclusion please see follow pages. 签发日期: 2020 年 04 月 18 日 Issue date: 2020-04-18
备注 Remark	/

郭长春

张志杰

张以峰

批准人:
 Approver:

审核人:
 Auditor:

编制人:
 Compiler:

日期: 2020/04/18
 Date:

日期: 2020/04/18
 Date:

日期: 2020/04/18
 Date:


通标标准技术服务(青岛)有限公司
 SGS-CSTC Standards Technical Services (Qingdao) Co., Ltd.
 第 3 页 共 7 页



除非另有书面协议, 本报告由本公司依据《服务通用条款》出具。
 《服务通用条款》印刷在正本报告纸背面, 或通过 <http://www.sgs.com/en/Terms-and-Conditions.aspx> 查询, 电子格式文件可通过 <http://www.sgs.com/en/Terms-and-Conditions/Terms-e-Document.aspx> 获取。请特别关注其中涉及责任限定, 赔偿以及司法管辖的相关条款。任何报告的持有方需知悉, 此报告内容仅反映SGS受限于客户指示下, 且在当时所得结论。SGS仅对其客户负责, 并且此报告不能免除交易各方根据交易文件所享有的权利和应履行的义务。未获得本公司书面批准, 本文件不得进行复制, 全文除外。任何未经授权对报告内容及形式进行的修改, 伪造或扭曲都是违法行为, 违法者将会被追究法律责任。
 注意: 检测/检验报告或证书的真实性, 请通过电话(86-755)8307 1443或邮箱CN.Doccheck@sgs.com查询。
 中国·青岛·城阳区株洲路143号通标中心 邮编: 266101
 www.sgs.com.cn
 t (86-532) 68999888 f (86-532) 80991955 e sgs.china@sgs.com



报告编号: SL22002232596201TX
 Report No.: SL22002232596201TX

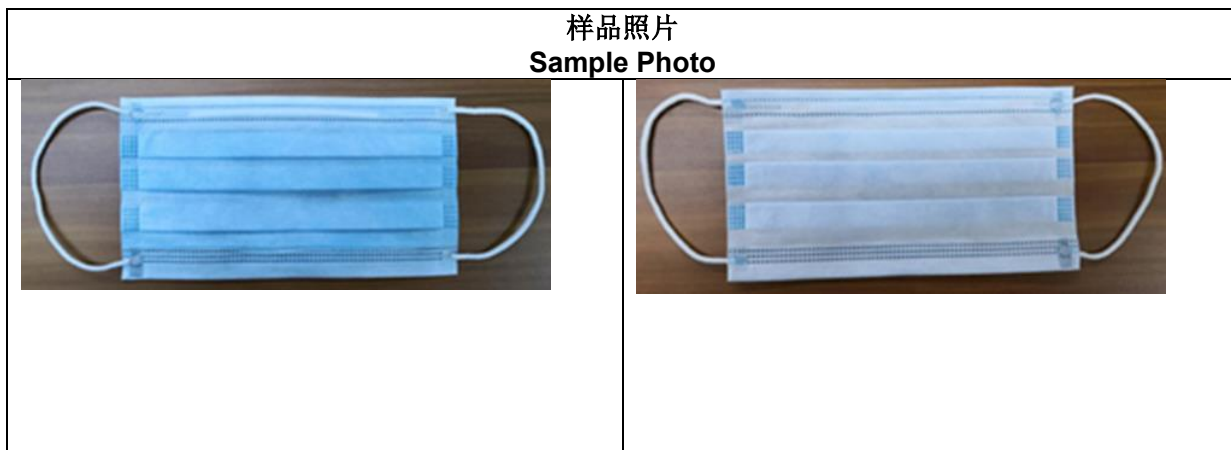

通标标准技术服务(青岛)有限公司
 SGS-CSTC Standards Technical Services (Qingdao) Co., Ltd.
 第 4 页 共 7 页



除非另有书面协议, 本报告由本公司依据《服务通用条款》出具。
 《服务通用条款》印刷在正本报告纸背面, 或通过 <http://www.sgs.com/en/Terms-and-Conditions.aspx> 查询, 电子格式文件可通过 <http://www.sgs.com/en/Terms-and-Conditions/Terms-e-Document.aspx> 获取。请特别关注其中涉及责任限定, 赔偿以及司法管辖的相关条款。任何报告的持有方需知悉, 此报告内容仅反映SGS受限于客户指示下, 且在当时所得结论。SGS仅对其客户负责, 并且此报告不能免除交易各方根据交易文件所享有的权利和应履行的义务。未获得本公司书面批准, 本文件不得进行复制, 全文除外。任何未经授权对报告内容及形式进行的修改, 伪造或扭曲都是违法行为, 违法者将会被追究法律责任。
 注意: 检测/检验报告或证书的真实性, 请通过电话(86-755)8307 1443或邮箱CN.Doccheck@sgs.com查询。
 中国·青岛·城阳区株洲路143号通标中心 邮编: 266101
 www.sgs.com.cn
 t (86-532) 68999888 f (86-532) 80991955 e sgs.china@sgs.com



报告编号: SL22002232596201TX

Report No.: SL22002232596201TX

检测结果

Test Results

检测项目 Test Items	单位 Unit	检测方法 Test Method	检测结果 Test Result	标准要求 Requirement	单项判定 Individual Judgment
大肠菌群 Coliforms	0.25g	GB 15979-2002 附录 B GB 15979-2002 Appendix B	未检出 Not detected	不得检出 Negative	符合 Pass
绿脓杆菌 Pseudomonas aeruginosa	0.25g	GB 15979-2002 附录 B GB 15979-2002 Appendix B	未检出 Not detected	不得检出 Negative	符合 Pass
金黄色葡萄球菌 Staphylococcus aureus	0.25g	GB 15979-2002 附录 B GB 15979-2002 Appendix B	未检出 Not detected	不得检出 Negative	符合 Pass
溶血性链球菌 Streptococcus hemolyticus	0.25g	GB 15979-2002 附录 B GB 15979-2002 Appendix B	未检出 Not detected	不得检出 Negative	符合 Pass
真菌菌落总数 Fungal colony count	0.25g	GB 15979-2002 附录 B GB 15979-2002 Appendix B	未检出 Not detected	不得检出	符合 Pass
细菌菌落总数 Total plate count	CFU/g	GB 15979-2002 附录 B GB 15979-2002 Appendix B	12	≤100	符合 Pass
细菌过滤效率* (BFE) Bacterial filtration efficiency (BFE)	%	YY 0469-2011 附录 B GB/T YY 0469-2011 Appendix B	98.7%	≥95%	符合 Pass
			98.5%		
			98.4%		
通气阻力* Ventilation resistance	Pa/cm ²	YY/T 0969-2013	12.3	≤49	符合 Pass
			12.4		
			12.5		

通标标准技术服务(青岛)有限公司
SGS-CSTC Standards Technical Services (Qingdao) Co., Ltd.
第 5 页 共 7 页



除另有书面协议,本报告由本公司依据《服务通用条款》出具。

《服务通用条款》印刷在正本报告纸背面,或通过 <http://www.sgs.com/en/Terms-and-Conditions.aspx> 查询,电子格式文件可通过 <http://www.sgs.com/en/Terms-and-Conditions/Terms-e-Document.aspx> 获取。请特别关注其中涉及责任限定,赔偿以及司法管辖的相关条款。任何报告的持有方需知悉,此报告内容仅反映SGS受限于客户指示下,且在当时所得结论。SGS仅对其客户负责,并且此报告不能免除交易各方根据交易文件所享有的权利和应履行的义务。未获得本公司书面批准,本文件不得进行复制,全文除外。任何未经授权对报告内容及形式进行的修改、伪造或扭曲都是违法行为,违法者将会被追究法律责任。

注意: 检测/检验报告或证书的真实性,请通过电话(86-755)83071443或邮箱CN.Doccheck@sgs.com查询。
中国·青岛·城阳区株洲路143号通标中心 邮编:266101
www.sgs.com.cn
t (86-532) 6899888 f (86-532) 80991955 e sgs.china@sgs.com



报告编号: SL22002232596201TX
Report No.: SL22002232596201TX

备注:

1、*检测项目由江苏国健检测技术有限公司（CMA 编号：161019130764）执行，不在本实验室的 CMA 认定范围内。

Remarks:

1. * Test items were carried out by Jiangsu Guojian Testing Technology Co., Ltd (CMA No. 161019130764) assessed as competent, were not included in the CMA Accredited Schedule for our laboratory.

此符合性声明仅基于本次实验室活动的实际值，未将本次实验室活动的结果不确定度影响计入。

The statement of conformity in this test report is only based on measured values by the laboratory and does not take their uncertainties into consideration.

报告结束
End of Report

通标标准技术服务(青岛)有限公司
SGS-CSTC Standards Technical Services (Qingdao) Co., Ltd.
第 6 页 共 7 页



除非另有书面协议，本报告由本公司依据《服务通用条款》出具。

《服务通用条款》印刷在正本报告纸背面，或通过 <http://www.sgs.com/en/Terms-and-Conditions.aspx> 查询，电子格式文件可通过 <http://www.sgs.com/en/Terms-and-Conditions/Terms-e-Document.aspx> 获取。请特别关注其中涉及责任限定、赔偿以及司法管辖的相关条款。任何报告的持有方需知悉，此报告内容仅反映SGS受限于客户指示下，且在当时所得结论。SGS仅对其客户负责，并且此报告不能免除交易各方根据交易文件所享有的权利和应履行的义务。未获得本公司书面批准，本文件不得进行复制，全文除外。任何未经授权对报告内容及形式进行的修改、伪造或扭曲都是违法行为，违法者将会被追究法律责任。

注意：检测/检验报告或证书的真实性，请通过电话(86-755)8307 1443或邮箱CN.Doccheck@sgs.com查询。
中国·青岛·城阳区株洲路143号通标中心 邮编: 266101
www.sgs.com.cn
t (86-532) 68999888 f (86-532) 80991955 e sgs.china@sgs.com

注意事项

statement

1. 报告无批准人签字、“检验检测专用章”及报告骑缝章，或经涂改，以及复印报告未加盖“检验检测专用章”均视作无效。

The report is considered invalidated in one or more of the following conditions: no approval signature; no testing seal of SGS; no cross-page seal; altered; a copy without the red testing seal of SGS.

2. 样品及相关信息由客户提供及确认，SGS 不承担证实客户提供信息的准确性、适当性和(或)完整性责任。

Above information and sample(s) was/were submitted and certified by the client, SGS quoted the information with no responsibility as to the accuracy, adequacy and/or completeness.

3. 除非另有说明，本检测结果仅对收到的样品负责。未经检验机构书面同意，委托人不得擅自使用检测结果进行不当宣传。

Unless otherwise stated the results shown in this test report refer only to the sample(s) tested. This document cannot be used for publicity, without prior written approval of the SGS.

4. 未经本公司批准，不得复制(全文复制除外)报告或证书。

The test report cannot be reproduced in any way, except in full content, without prior approval in writing by the laboratory.

5. 对检测报告若有异议，应于收到报告之日起十五日内向本单位提出。

Should you have any queries or objection to the test report, please contact us within 15 days after receiving the report.

地 址：青岛市崂山区株洲路 143 号

Address: SGS Center, No.143, Zhuzhou Road, Laoshan District, Qingdao, China.

电话：0532-68999318

邮编：266101

传真：0532-83884258

Tel: 0532-68999318

Zip: 266101

Fax: 0532-83884258

E-mail: Bella.cheng@sgs.com